10. Утилизация

Шкаф, потерявший потребительские свойства, подлежит утилизации в виде эпидемиологически безопасных отходов, приближенных по составу к твердым бытовым отходам. Сбор, временное хранение и вывоз этих отходов следует выполнять в соответствии со схемой обращения с медицинскими отходами, принятой в организации, где использовался шкаф по правилам, предусмотренным в СанПиН 2.1.3684-21 для медицинских отходов класса «А».

11. Свидетельство о приемке

Шкаф медицинский для хранения медицинских изделий (мод.2) изготовлен и принят в соответствии с техническими условиями ГИКС.942810.107 ТУ и признан годным для эксплуатации.

Код 14346

№ партии _____


Штамп ОТК_____

Дата упаковки_____

Компания ЕЛАМЕД
Изготовитель:
АО «Елатомский приборный завод»
Адрес: 391351, Россия, Рязанская область,
Касимовский район, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25

Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-350-06-13
E-mail: lpu@elamed.com
Сайт компании: lpu.elamed.com

Регистрационное удостоверение № РЗН 2019/9071 от 18.10.2021

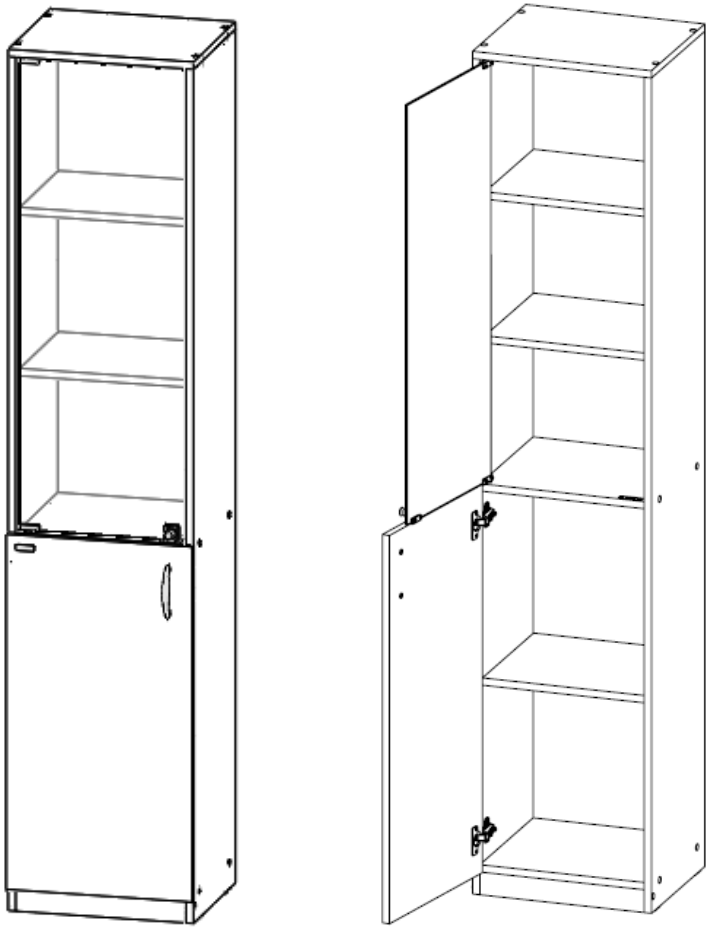

ШКАФЫ МЕДИЦИНСКИЕ ПО ГИКС.942810.107 ТУ

ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ (мод.2)

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ГИКС.942818.200 РЭ

Шкаф медицинский для хранения медицинских изделий (мод.2) (в дальнейшем шкаф) предназначен для применения в специальном медицинском помещении (процедурном кабинете, операционной, лабораториях и т.д.), требующем проведения дезинфекционной обработки, для размещения медицинских изделий, фармпрепаратов, для проведения медицинских исследований, направленных на профилактику, диагностику, лечение заболеваний и мониторинг состояния организма человека.

Показания к применению: Шкаф устанавливается в процедурном кабинете или кабинете врача по профилю для размещения медицинских изделий для организации процедур по профилактике, диагностике, лечению заболеваний и мониторинга состояния организма человека.

Противопоказания: **не имеет.**

Меры предосторожности:

! ЗАПРЕЩАЕТСЯ облокачиваться и надавливать на верхние грани открытых дверей!

1. Основные параметры и размеры

1.1 Масса изделия 29,3±2,9 кг.

1.2 Габаритные размеры (длина х ширина х высота) мм: (400х380х1855)± 4.

2. Характеристики

2.1 Календарный срок службы изделия – 5 лет от начала эксплуатации до достижения предельного состояния. Критерий предельного состояния – невозможность или экономическая нецелесообразность восстановления изделия.

2.2 Нагрузочные характеристики шкафа при равномерном распределении нагрузки:

- на полку из плиты ламинированной древесностружечной – 15 кг.

2.3 Зазоры в проемах на сторону для дверей не более 4,0 мм. Двери шкафа открываются и закрываются с усилием не более 3 даН. Угол открывания двери шкафов должен быть не менее 110º. Шкаф имеет не регулируемые по высоте опоры в виде подпятников.
Толщина стеклянной дверцы – 4 мм.

2.4 При эксплуатации шкаф устойчив к воздействию климатических факторов по ГОСТ Р 50444-92 для исполнения УХЛ категории 4.2: температура окружающего воздуха от +10°С до +35°С; номинальное значение относительной влажности 80% при +25°С.

2.5 Изделие изготовлено из ЛДСП. Шкаф разделен на 2 секции: в верхней секции расположены 2 съёмные полки из ЛДСП, в нижней секции - 1 съёмная полка из ЛДСП. Нижняя секция закрывается дверью из ЛДСП. Верхняя секция закрывается прозрачной стеклянной дверцей с фиксацией замком. Задняя стенка изготовлена из плиты декоративной древесноволокнистой (ДВПО). Шкаф устанавливается на 4 мебельных подпятника без возможности регулировки по высоте. Изделие поставляется в разобранном виде, сборка осуществляется в соответствии с инструкцией по сборке представителями предприятия-изготовителя.

3. Комплект поставки:

Наименование	Количество, шт
Шкаф медицинский для хранения медицинских изделий (мод.2)	1
- Руководство по эксплуатации	1
- Инструкция по сборке	1

4. Транспортирование и хранение

4.1 Шкаф транспортируется в разобранном виде в транспортной упаковке.

4.2 Шкаф транспортируется всеми видами закрытого транспорта (кроме морского) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта, в условиях группы 5 по ГОСТ 15150-69 (температура воздуха от -50°С до +50°С, относительной влажности воздуха до 100% при температуре +25°С).

4.3 Условия хранения шкафа в транспортной упаковке предприятия-изготовителя на складах поставщика и потребителя – в условиях группы 2 по ГОСТ 15150-69 (температура воздуха от -50°С до +40°С и относительная влажность не более 98% при +25°С).

5. Дезинфекция

Поверхности шкафа устойчивы к дезинфекции химическим методом по МУ-287-113:3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177-88 с добавлением 0,5% моющего раствора типа «Лотос» по ГОСТ 25644-96 и 1% раствора хлорамина по ТУ 9392-031-00203306-2003.

6. Правила эксплуатации

ВНИМАНИЕ!!! В случаях появления сомнения в исправности или правильной работе изделия, при повреждениях составных частей изделия обратитесь к предприятию-изготовителю по адресу: 391351, Россия, Рязанская область, Касимовский район, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод».

Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 350-06-13.

НЕ ПЫТАЙТЕСЬ УСТРАНИТЬ НЕИСПРАВНОСТИ САМОСТОЯТЕЛЬНО.

6.1 Подготовка к работе:

6.1.1 После хранения шкафа или перевозки его в упаковке при температуре ниже +10°С изделие необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 30 мин.

6.1.2 После сборки шкафа проверьте следующее:

- крепёжные элементы шкафа выполняют свое функциональное назначение.

6.2 Ограничения в процессе эксплуатации шкафа:

Во избежание преждевременного выхода из строя шкафа не допускается:

- нагружать рабочие поверхности выше норм, установленных в п. 2.2;
- скопление жидкости на поверхностях шкафа, в том числе и во время дезинфекции;
- подвергать поверхности шкафа воздействию предметов, вызывающих появление царапин на рабочей поверхности;

6.3 По механической безопасности шкаф соответствует требованиям ГОСТ 16371-2014.

7. Гарантия изготовителя

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям нормативной документации при условии сборки мебели представителем предприятия-изготовителя, соблюдения потребителем вышеизложенных правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

7.2 Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня сборки мебели представителем предприятия-изготовителя.

7.3 Гарантийный срок хранения – 60 месяцев с даты упаковывания

8. Техническое обслуживание

Техническое обслуживание шкафа включает в себя:

- поддержание технического состояния шкафа в виде:

а) визуального осмотра всей конструкции изделия не реже одного раза в месяц;

б) протяжки винтов ручек дверей не реже одного раза в месяц;

в) протяжки всей крепёжной фурнитуры конструкции не реже одного раза в 6 месяцев;

- очистки от загрязнений поверхностей шкафа путём протирания ветошью, смоченной в воде (при необходимости);
- дезинфекции поверхностей шкафа путём протирания ветошью, смоченной в растворе дезинфицирующего средства с периодичностью, регламентированной утвержденным внутренним порядком проведения санитарной обработки в медицинской организации, в помещениях которой размещено изделие.

9. Ремонт

Ремонт шкафа включает в себя замену пришедших в негодность деталей либо узлов, если они не выполняют функции устройств, обеспечивающих полную функциональность шкафа.